

「UN、CRE、UA、IP」 検査内容変更のお知らせ



2024年12月
株式会社グッドライフデザイン

このたび下記の検査項目におきまして、キャリブレーターを変更させていただきたくご案内いたします。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【 項目名 】

UN（血清、尿）、CRE（血清、尿）、UA（血清）、IP（血清、尿）

【 変更日時 】


2025年1月6日（月）より

【 変更内容 】

	変更前	変更後
UN	デタミナー標準液 尿素窒素測定用	メタボリード標準血清 HDL・LDL-C 測定用
CRE	デタミナー標準液 クレアチニン測定用	
UA	デタミナー標準液 尿酸測定用	
IP	デタミナー標準液 無機リン測定用	

※依頼方法や検体提出方法、試薬に変更はございません。

【 相 関 】

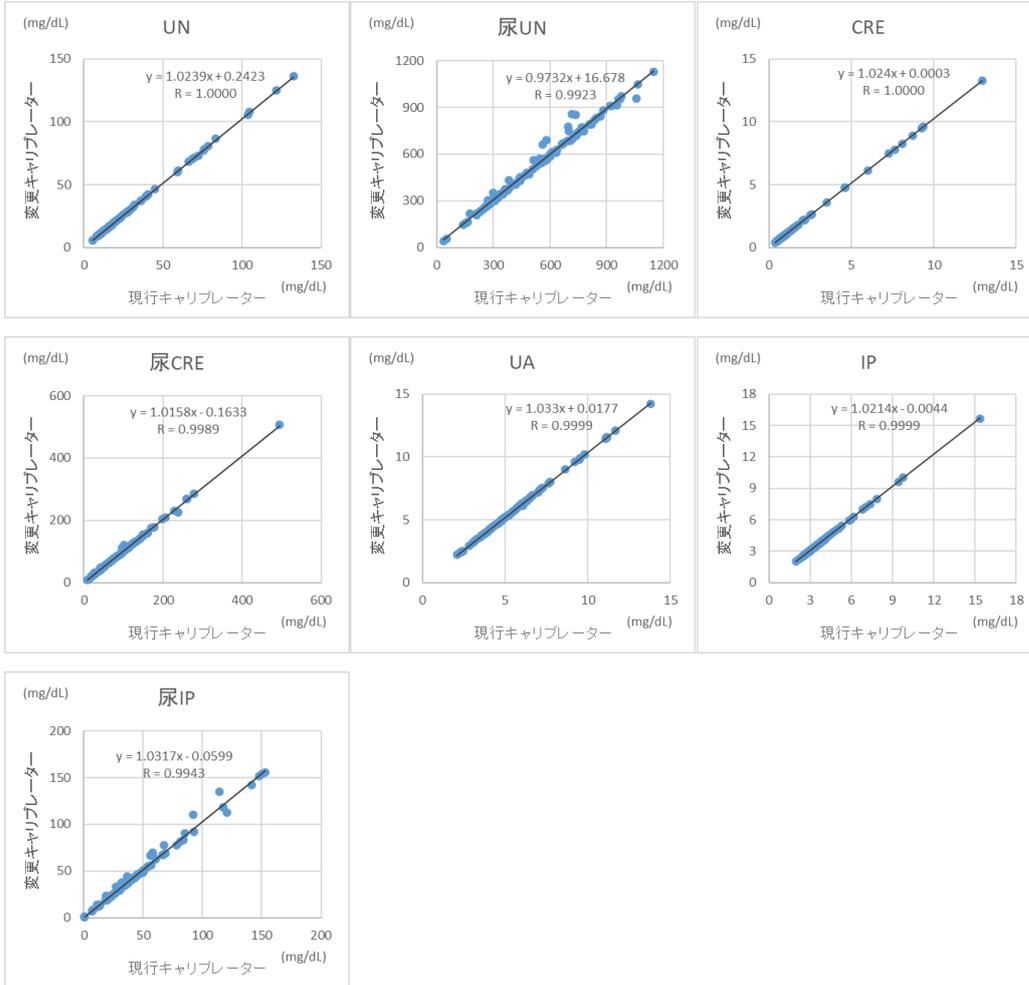

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学/免疫部門

内線：6063