

葉酸 (FOL)

検査内容変更のお知らせ



2025年 3月
株式会社グッドライフデザイン

このたび葉酸 (FOL) におきまして、測定試薬を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【項目名】葉酸 (FOL)

【変更日時】2025年4月1日 (火) 測定分より


【変更理由】改良品 (ビオチンによる干渉が低減する特徴) への変更

【変更内容】以下の通り

葉酸 (FOL)	変更前	変更後
試薬名	エクルーシス試薬葉酸IV (S300)	名称変更なし (試薬箱右上にV2表記)
測定範囲	0.6~40.0 ng/mL (希釈域含む)	下限値変更あり 2.0 ~40.0 ng/mL (希釈域含む)
基準範囲 (設定根拠)	3.9~26.8 ng/mL (メーカー推奨基準値)	変更なし
測定法	ECLIA法	変更なし

相関結果

① 相関 (cobas e801 現行試薬×新試薬)

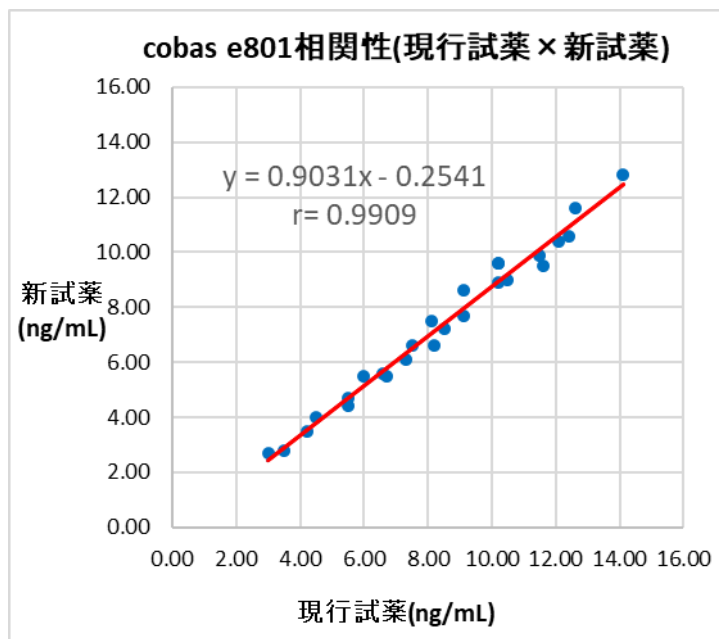

【その他】

- ・ 検体採取法に変更はございません。

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン
ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学/免疫

内線：6063